

Update 4.02a

Paket # 00394

Allgemein

Die Menüauswahl zum hinzufügen von Dokumenten wurde um einen PDF-Scanner ergänzt, welcher mehrseitige Dokumente unterstützt. (Dies gilt für alle Bereiche, in denen Dokumente und Dateien hinterlegt werden können).

Beispiel Produktverwaltung:

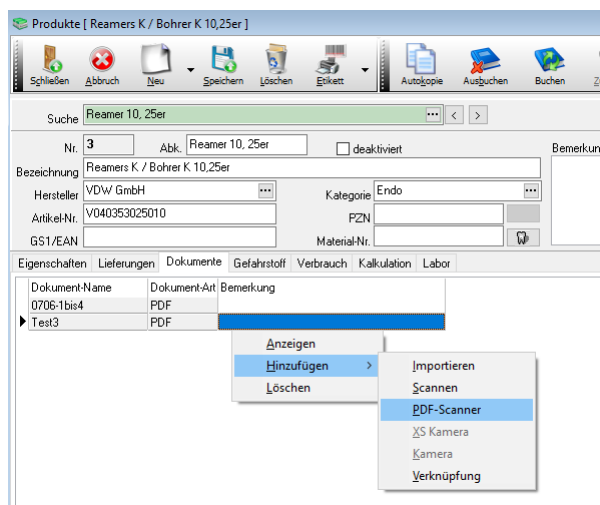


Abbildung 1: PDF Scanner in der Produktverwaltung

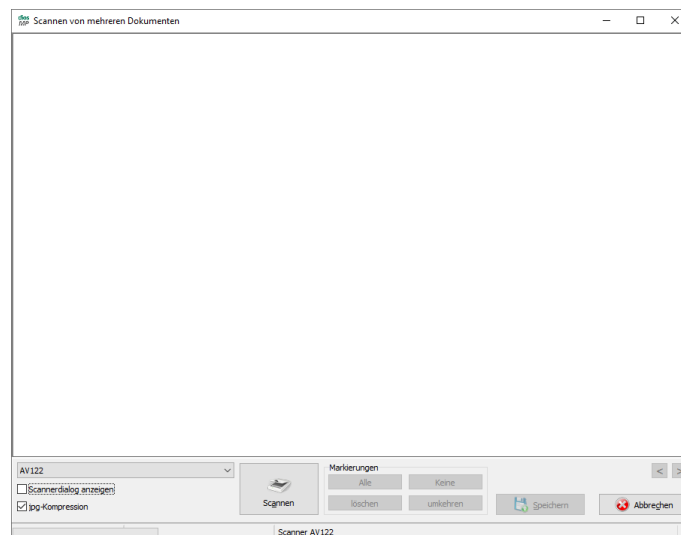


Abbildung 2: PDF Scanner

Labor

Verbessert: beim Auslösen eines Ausdrucks wird zuvor automatisch gespeichert um sicherzustellen, dass alle Daten korrekt gedruckt werden.


Produkte

behalten: auch deaktivierte Mitarbeiter werden nun bei betroffenen Lieferungen weiterhin angezeigt.

behalten: das Einbuchen eines Original-Barcodes wurde nach der Hersteller-Neuaufnahme nicht weiter fortgeführt, so dass der Barcodeabgleich unter Umst. zweimal gemacht werden musste.

Registrierung

Die Demoversion wird zur besseren Übersicht im Registrierungsdialog explizit auch als Lizenztyp angezeigt.

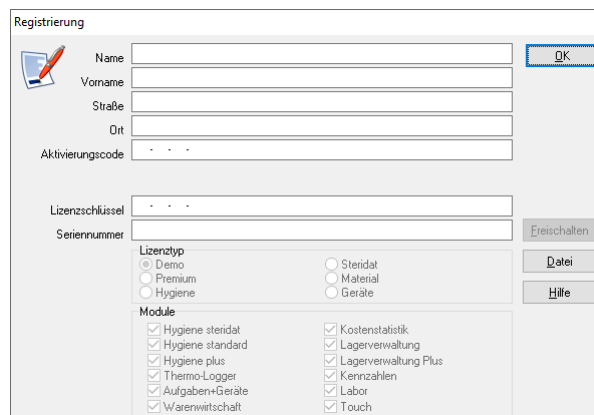

Registrierung

Name

Vorname

Straße

Ort

Aktivierungscode

Lizenzschlüssel

Seriennummer

Lizenztyp

Demo Steridat

Premium Material

Hygiene Geräte

Module

Hygiene steridat Kostenstatistik

Hygiene standard Lagerverwaltung

Hygiene plus Lagerverwaltung Plus

Thermo-Logger Kennzahlen

Aufgaben+Geräte Labor

Warenwirtschaft Touch

Abbildung 3: Registrierung

Schnittstellen

Neue diosHygDevLib.dll V 3.1.3.2

Neu: Faro Einstellung, um Textprotokolle von Faro Desinfektoren besser darzustellen.

Verbessert: Darstellung von HTML Protokollen

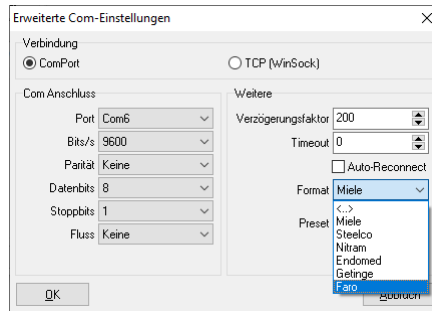


Abbildung 4: Neue Faro Einstellung

Verbrauchsliste

Die Spalte *Produkt-Nr.* wurde ergänzt.

Einzelverbrauch		Gesamtverbrauch					
Materialien	Stenlgüter	Desinfektionsgüter	Personal	Beh.-Tätigkeiten	Geräte		
Pat.-Nr.	Buchung	Verbraucht am	Produkt-Nr.	Produkt	Artikel-Nr.	Kategorie	
13034		11.02.2020	106	Prime & Bond NT	60667240	Kunststoffe	
13034		11.02.2020	693	Jumbo-Etch-Rite Kit	277902	Kunststoffe	
2557		11.02.2020	102	Ultracain D-S forte		Anästhetika	
3782		11.02.2020	1184	Air Flow soft Zi4		Prophylaxe	
3782		11.02.2020	1177	Etalex Fluid Zi4		Prophylaxe	
3782		11.02.2020	1162	C/S Prophyl Paste RDA250		Prophylaxe	
3782		11.02.2020	1174	Patientenumhang Tena S/M		Einwegartikel	
0	Laborarbeit	09.03.2020	1300	Rosenbohrer 027		Bohrer	
0	Laborarbeit	09.03.2020	1301	NF/RC. Nockenzahn schraub	0234763	Bohrer	Implantate

Abbildung 5: Spalte Produkt-Nr.